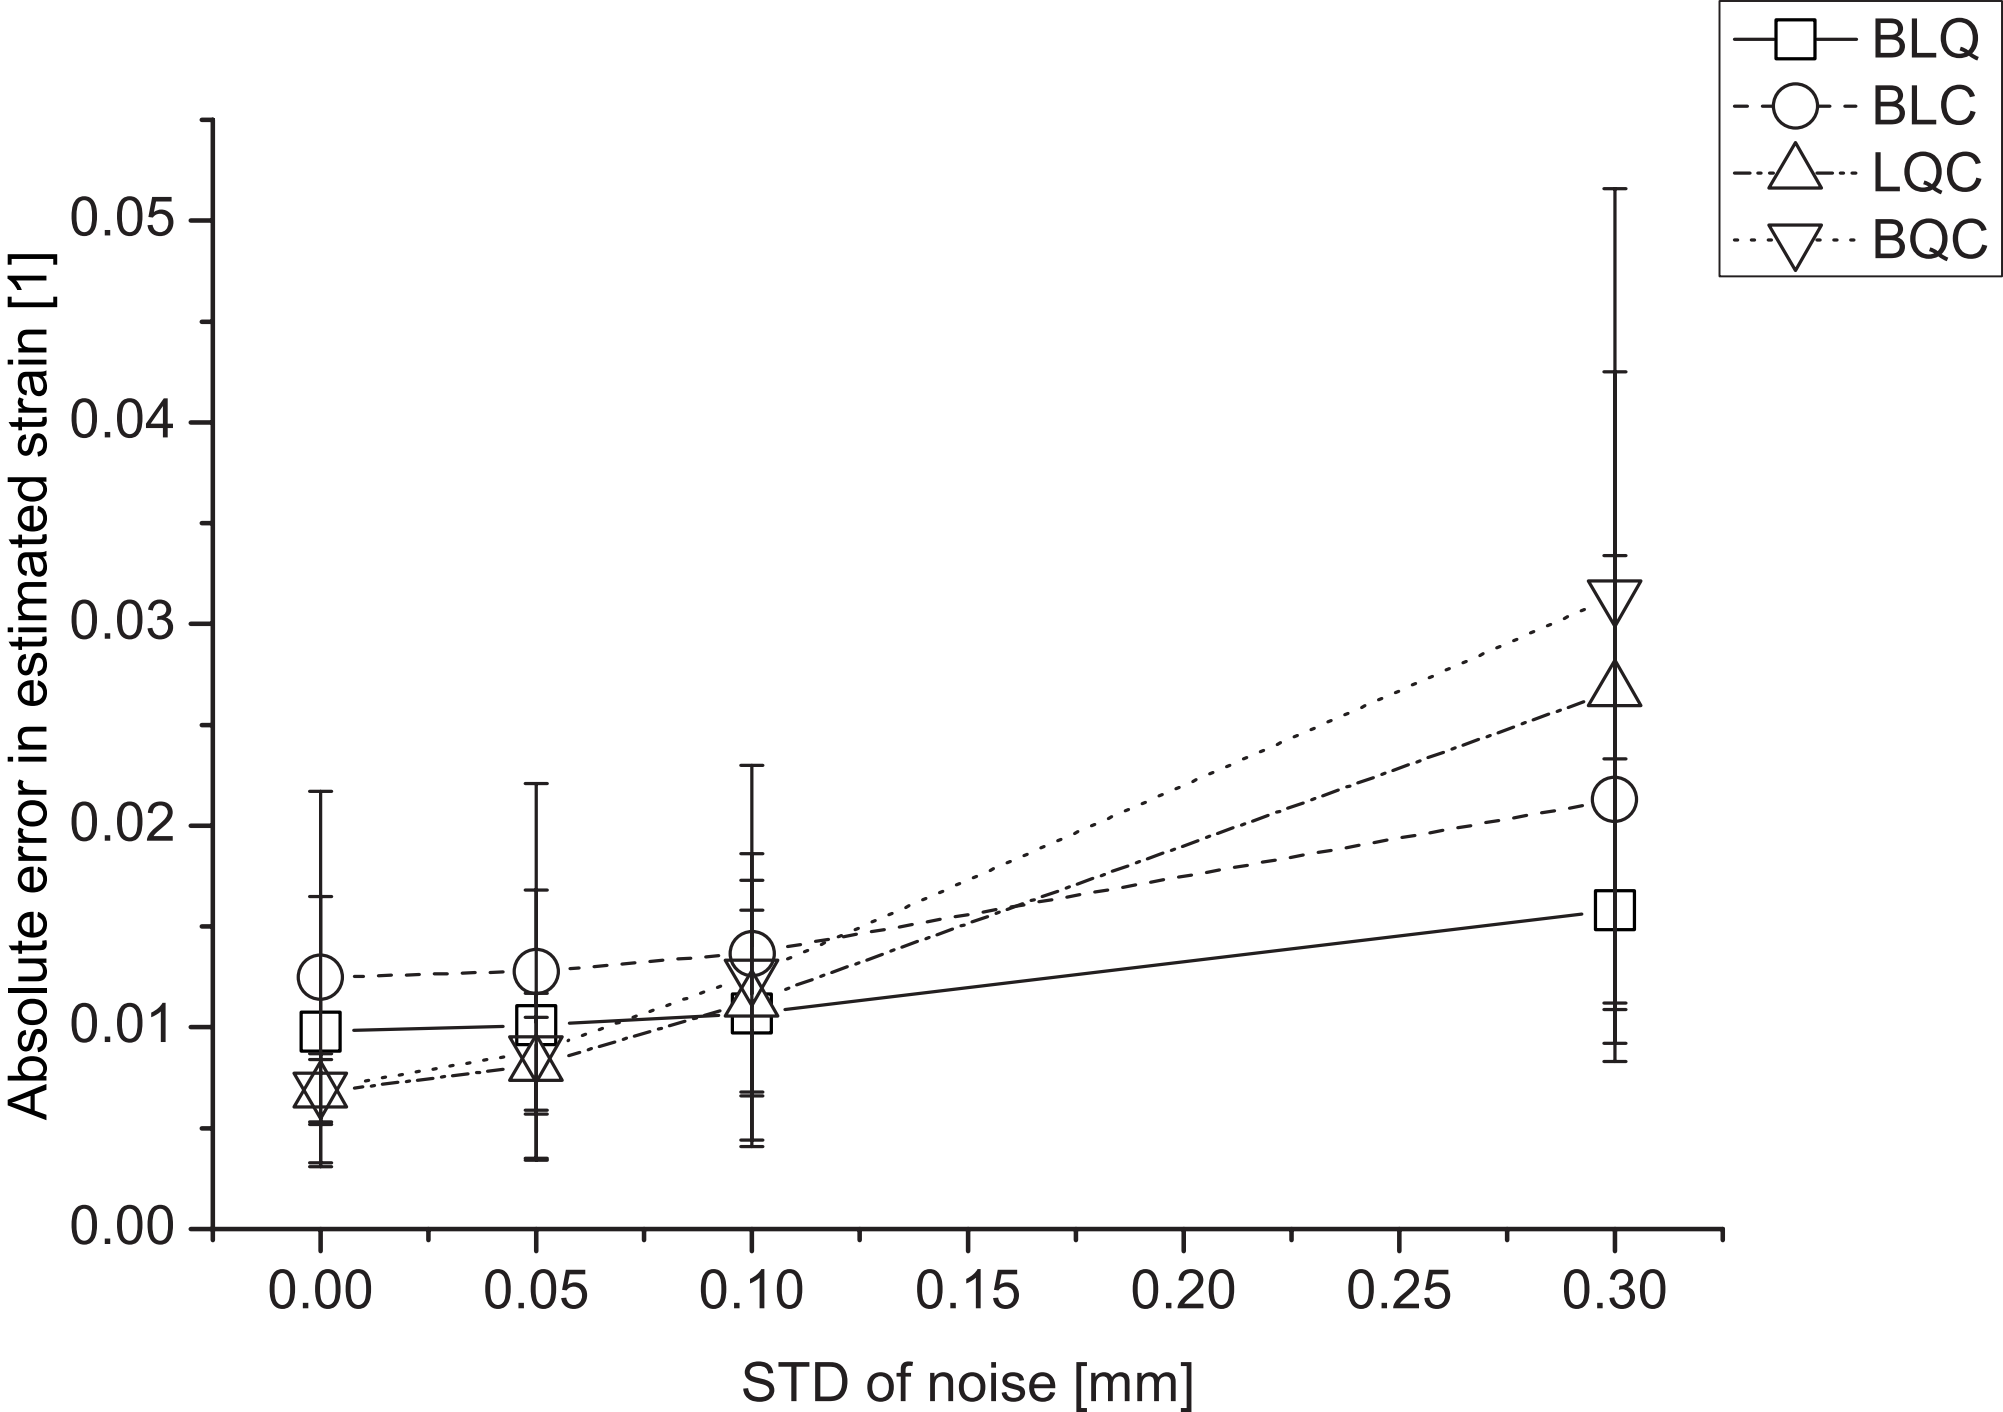
BLQ
BLC
LQC
BQC
Absolute error in estimated strain [1]
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
STD of noise [mm]