A

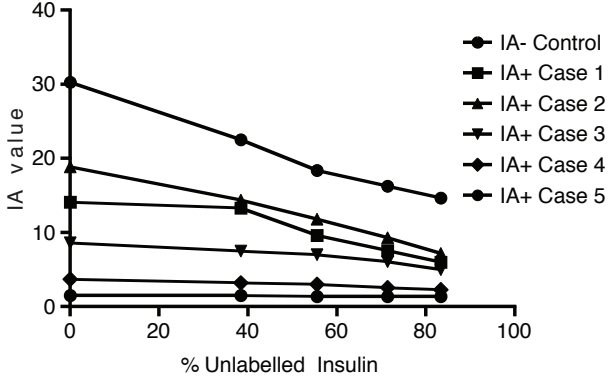

B

Sample	Biotinylated Insulin (ng/well)	Non-biotinylated Insulin (ng/well)	Mean Signal	Standard Deviation	%CV	IA Level (ECL)
IA- Control	0	0	247	44.2	18	Background
	1.25	0	360	15.2	4.2	1.4
		1.56	354	11.5	3.3	1.4
		6.25	345	5	1.4	1.4
IA+ Control	0	0	906	12.2	1.3	Background
	1.25	0	12754	526.8	4.1	14.1
		1.56	8720	2023	23	9.6
		6.25	5422	1323	24	6.0

C

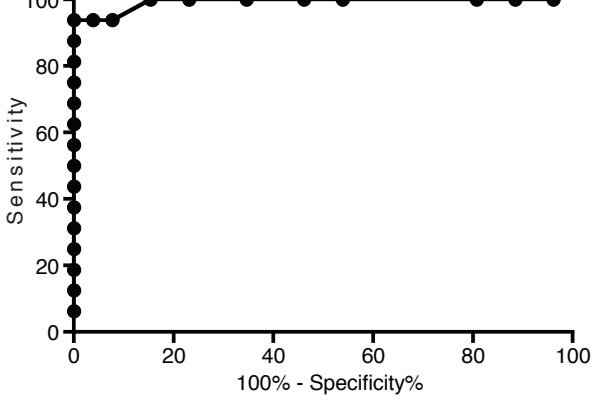
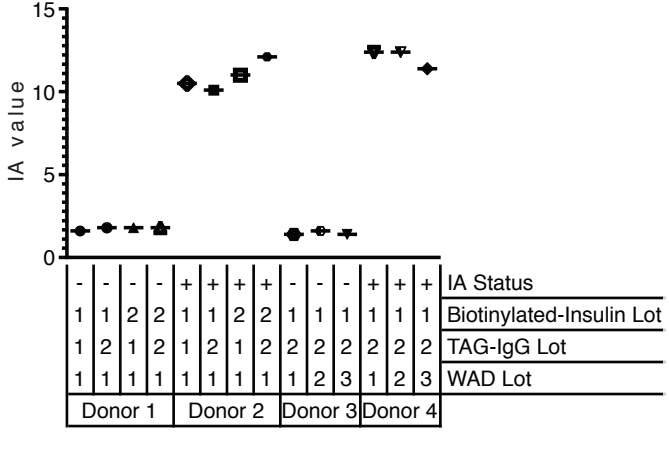
D